

MEMORANDO SEI Nº 25936485/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 30 de junho de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 149/2025**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos)

Em atenção à Convocação (SEI nº 25804798), encaminhamos as informações da análise das amostras encaminhadas pela empresa UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA para o item 67:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Parecer
67	910969 - AGULHA BIOPSIA P/EXAME MIELOGRAMA 15G X 4,3 A 5CM DESC. AGULHA PARA MIELOGRAMA (ASPIRADO DE MEDULA ÓSSEA), 15G x 4,3 A 5CM DESCARTÁVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	Conforme Análise (SEI nº 25930924), O produto ofertado apresenta importante falha em relação à proteção da agulha. Todas as amostras chegaram com a proteção da agulha solta dentro da embalagem; tal falha resultou em perfuração do papel grau cirúrgico antes do uso do material, conforme verifica-se nas imagens constantes no documento SEI nº 25930912. Considerando que o edital exige material estéril e houve violação da embalagem, este requisito não foi atendido. AMOSTRA REPROVADA.

Em atenção à Convocação (SEI nº 25837706), informamos que não foi entregue nesta Secretaria da Saúde a amostra da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA para o item 15.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 30/06/2025, às 09:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25936485** e o código CRC **26ABDD39**.

ANÁLISE SEI Nº 25930924/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 27 de junho de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 149/2025

ITEM 67- AGULHA BIOPSIA P/EXAME MIELOGRAMA 15G X 4,3 A 5CM

DESCRIÇÃO	910969 - AGULHA BIOPSIA P/EXAME MIELOGRAMA 15G X 4,3 A 5CM DESC. AGULHA PARA MIELOGRAMA (ASPIRADO DE MEDULA ÓSSEA), 15G x 4,3 A 5CM DESCARTÁVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
FORNECEDOR	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA
MARCA	UNIT/ EMO-B 15/28L
REGISTRO ANVISA	10287070024
LOTE	01111527112024-0
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos: a embalagem chegou violada devido a proteção da agulha ter vindo solta na embalagem

 Adequada inadequada Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: Considerando que a embalagem chegou violada, esta perdeu a esterilidade

 Adequada inadequada Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: O produto ofertado apresenta importante falha em relação à proteção da agulha. Todas as amostras chegaram com a proteção da agulha solta dentro da embalagem; tal falha resultou em perfuração do papel grau cirúrgico antes do uso do material, conforme verifica-se nas imagens constantes no documento SEI nº 25930912. Considerando que o edital exige material estéril e houve violação da embalagem, este requisito não foi atendido.

 Adequada inadequada Não se aplica



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 27/06/2025, às 16:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.




A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25930924** e o código CRC **7FC9B92F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.023330-2

25930924v3

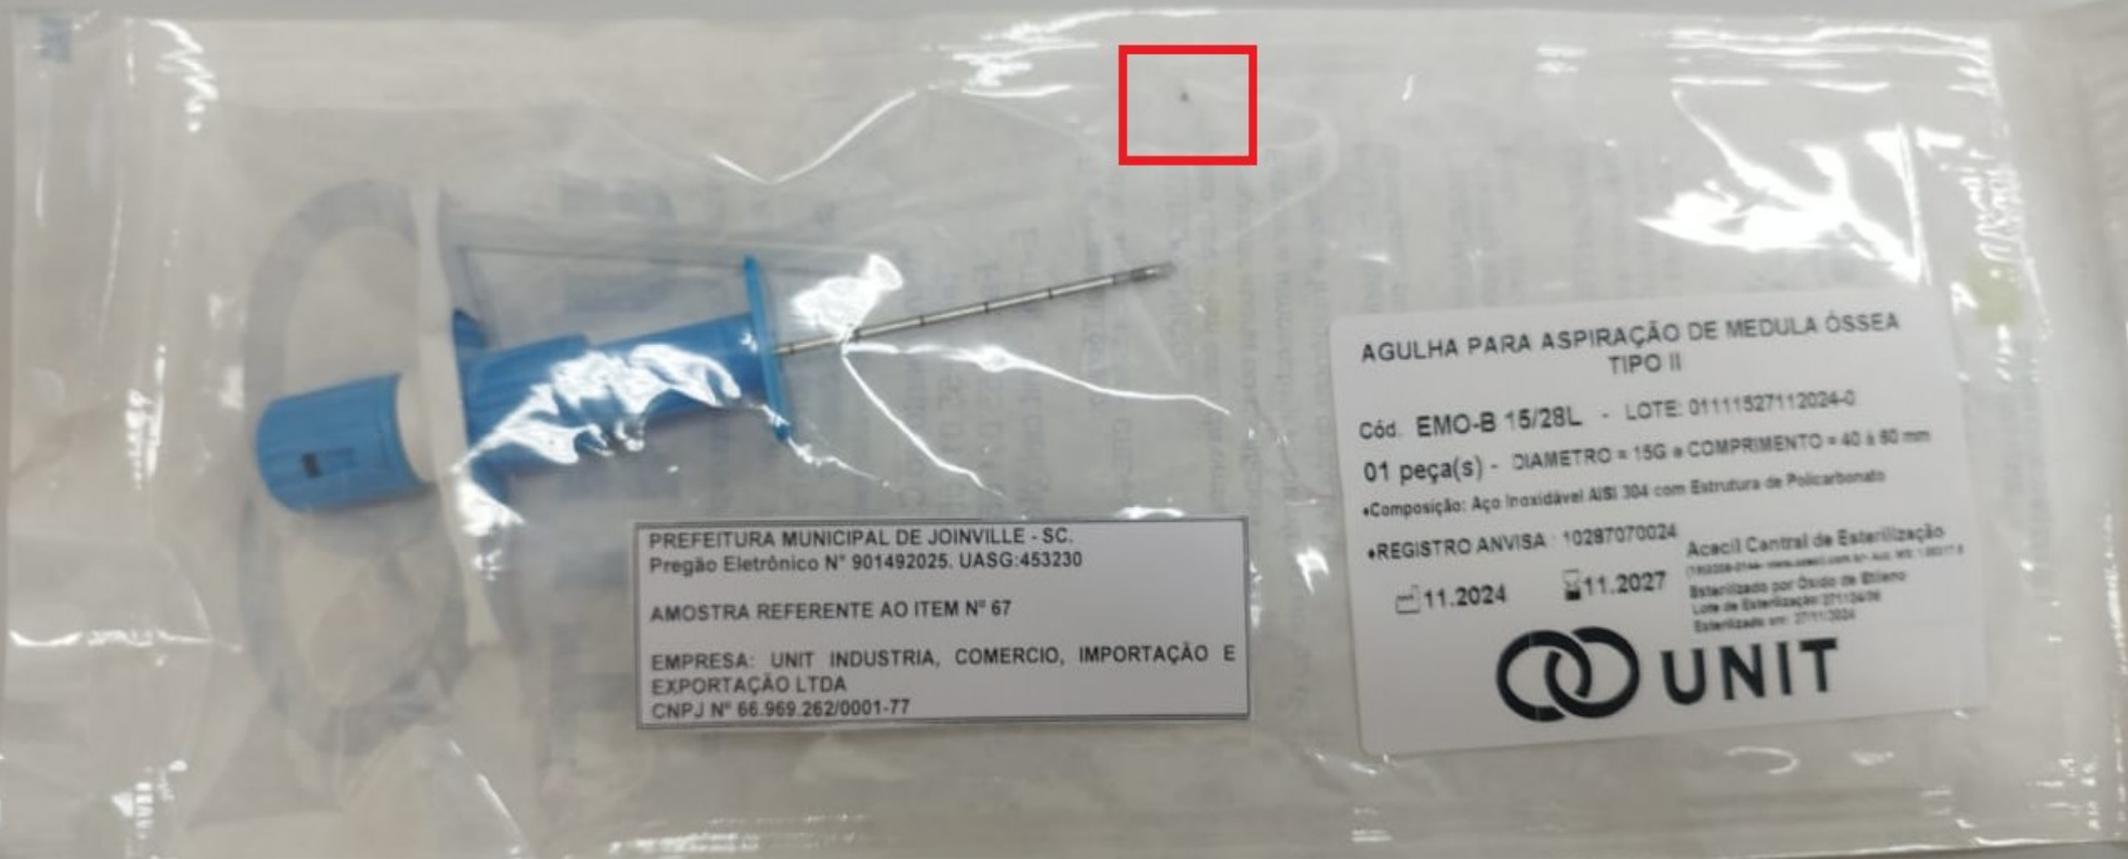

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC,
Pregão Eletrônico N° 901492025. UASG:453230

AMOSTRA REFERENTE AO ITEM N° 67

EMPRESA: UNIT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ N° 66.969.262/0001-77

AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA
TIPO II

Cód. EMO-B 15/28L - LOTE: 01111527112024-0

01 peça(s) - DIAMETRO = 15G « COMPRIMENTO = 40 à 80 mm

•Composição: Aço Inoxidável AISI 304 com Estrutura de Policarbonato

•REGISTRO ANVISA : 10297070024

11.2024 11.2027

Acetil Central de Esterilização
Esterilizado por Óxido de Etileno
Lote de Esterilização: 271134/06
Esterilizado em: 271113024

UNIT



UNIT

Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Rua Beirrossa de Bela Vista, 346 - Vila Congonhas
CEP 04612-001 - São Paulo - SP - Brasil

CNPJ: 66.969.262/0001-77 - I.E.: 113.303.062.115

Site - www.unitmed.com.br

Atendimento ao Consumidor

Tel.: ++55 011 5536-9331

Fax: ++55 011 5542-6850

E-mail - unit.ciel@terra.com.br

Responsável Técnico:
Adão Isaias da Silva - CREA-SP: 5070449660

APIROGÊNICO:

Não utilizar em caso da embalagem se encontrar aberta ou danificada.

Estocar à temperatura ambiente ao abrigo de umidade e incidência direta de luz.

Produto Estéril:

Estérilizado por Óxido de Etileno (ETO).

Produto Médico de Uso Único:

Descartar após o uso.

Proibido reprocessar.

DESCARTE:

Descartar a agulha usada em local apropriado para materiais cortantes potencialmente contaminados.



Contém 1 unidade

Indústria Brasileira



MUDA PARA VERDE
QUANDO EXPOSTO AO GÁS ETO