






Equipamentos - 2
Potência (HP) - 2
Fluxo de ar (L/min) - 167
Tanque (L) - 40
Dimensões (cm) - 45 x 45 x 72
Pressão Máxima - 120 PSI 10%
Tensão - Monofásico AC 220
Frequência - 60Hz
Consumo (wat) - 1496



Especificações Técnicas

Bomba de Vácuo

- 1- Ponto de sucção PVC esgoto Ø40 mm
+ luva com bucha de latão Ø25 x 3/4"
rente ao piso
- 2-ponto de água PVC Ø20 mm
+ luva com bucha de latão Ø25 x 3/4",
ligado a rede de água.
- 3-Ponto de esgoto PVC Ø40 mm
+ bucha de latão Ø25 mm
x 1/2"e adaptador 1/2"x 1/4".
- 4-Tomada de três pinos, fios 3 x 2,5 mm²
com disjuntor exclusivo para bomba de
25 Amperes.

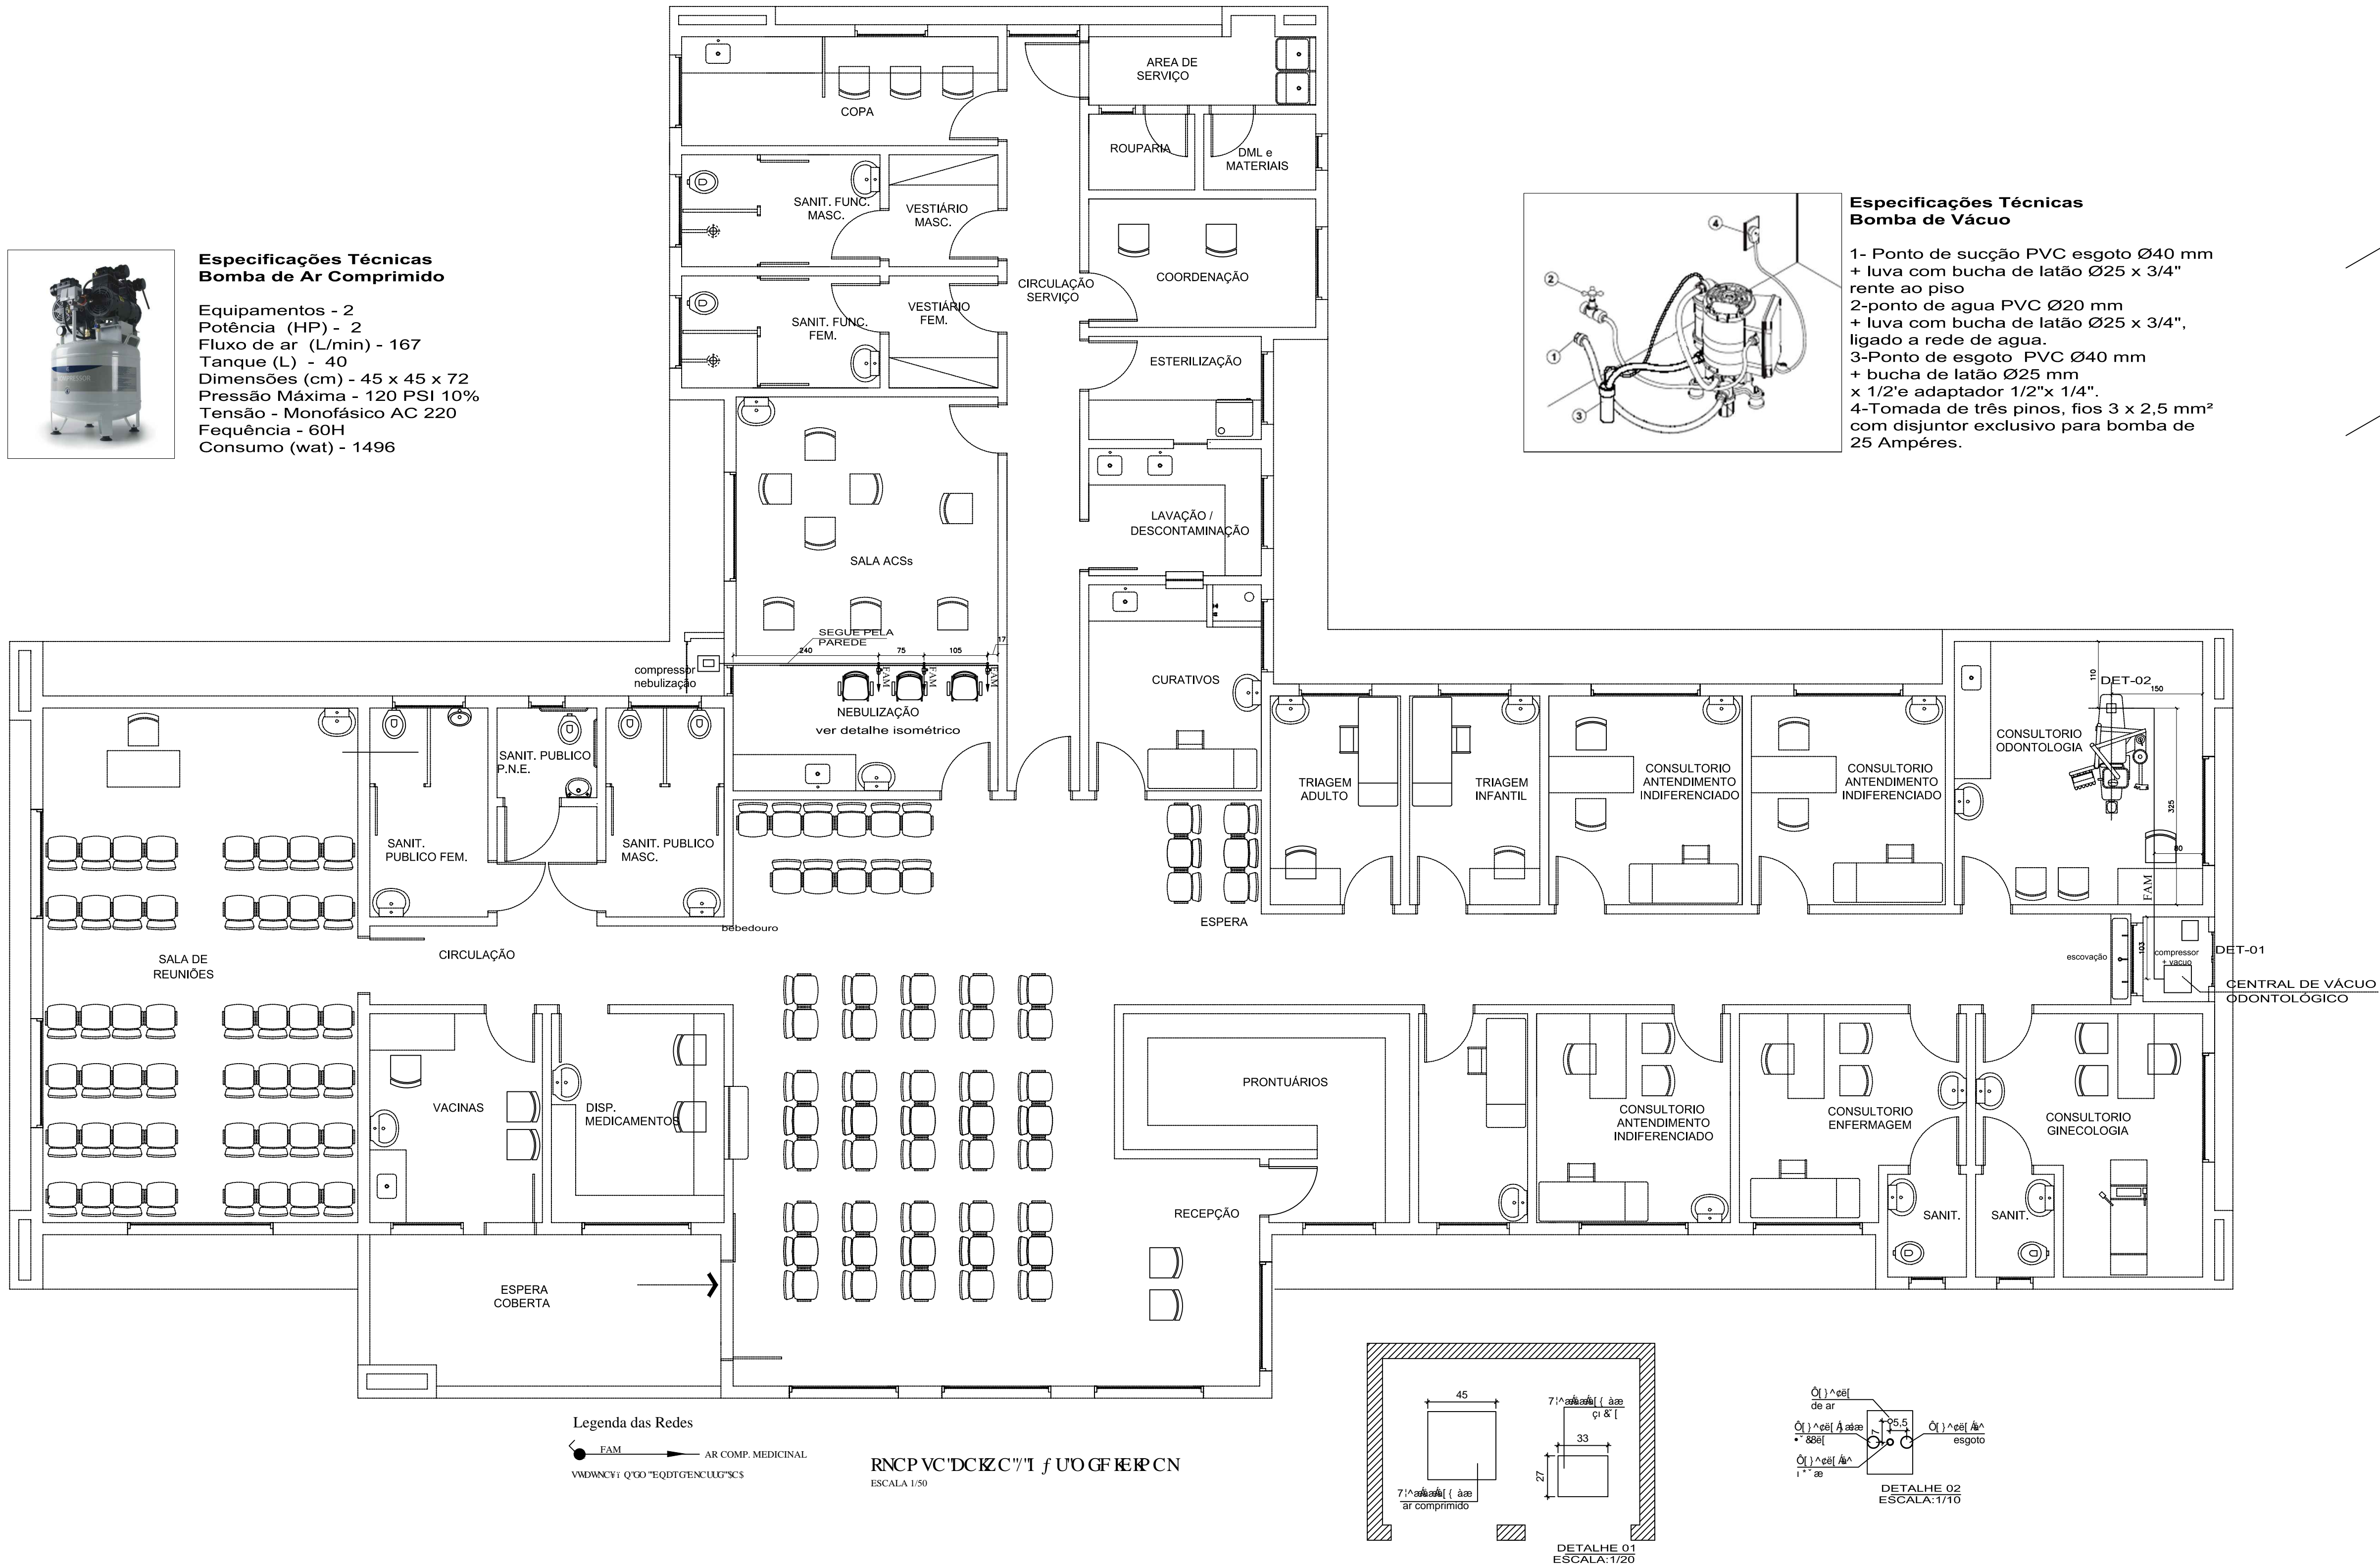

NOTAS:		TABELA DE PENAS PARA PLOTAGEM	
01	conferir as medidas em toco.		pesadora da ponta
02	todas as cotas estão em centímetros	1	vermelho 0,1
03	em caso de dúvidas, consultar o autor do projeto.	2	amarelo 0,2
04	as medidas referem-se às dimensões acabadas	3	verde 0,3
		4	azul 0,4
		5	azul 0,5
		6	magenta 0,6
		7	0,8
		8	1,0
		9	cor 08 -
			cinza 1,2

<p>Secretário Municipal da Saúde</p>	<p>Assinatura Autor Projeto:</p> <p>ENG. MECÂNICO: AURÉRIO CARMELO BOGO CREA: 77847-0/ SC</p>	<p>0*) 1) 2) 3) 4) 5) 6)</p>
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Secretaria da Saúde Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC</p>	
<p>TERCEIROS</p>	<p align="center">HELICON</p>	<p>Helicon Construções Projetos Serviços Ltda. Rua Conselheiro Lafayette, 190 89.200-590 Joinville - SC Fone: (047) 3309-6002</p>
<p>Helicon</p>	<p align="center">Construções Projetos Serviços</p>	
<p>Projeto GASES MEDICINAIS</p>	<p align="center">UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO-AVENTUREIRO R. Santa Luzia, Aventureiro - Joinville - SC</p>	
<p>Requerente</p>	<p>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>	<p>Q 1 9 4 6 4</p>
<p>Endereço</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE</p>	<p>PLANTA BAIXA DETALHES EXECUTIVOS DETALHE ISOMETRICO</p>
<p>Assinatura</p>	<p>ENG. MECÂNICO AURELIO CARMELO BOGO CREA: 77847-0/ SC</p>	
		<p align="center">Indicada</p>
	<p>Assin. P.C.T.</p>	<p>Assinada</p>
	<p>Assin. CAD</p>	<p>Ingr. (Módulo) 404</p>
<p>Recebido por:</p>	<p>Assinatura CAD: DEIDIVI</p>	<p>Data: Dezembro/2011</p>
	<p>Assin. (Módulo) 4</p>	<p align="center">G 01/01</p>