

MEMORANDO SEI Nº 25349216/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 05 de maio de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras- Pregão Eletrônico **075/2025**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem - fios cirúrgicos.

Encaminhamos as informações das amostras já avaliadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
16	909817 - FIO CIR. DE POLIPROPILENO 5-0 AG 1,5 a 1,7CM CARDIOV.	VOLARE COMERCIO LTDA	SHALON P502MR V15	Conforme Análise SEI nº 25349095, durante a avaliação, a equipe técnica constatou que a amostra não atendeu aos seguintes requisitos: - Resistência a tração sobre nó; - Maleabilidade; - Diâmetro de arame (espessura da agulha compatível com a espessura do fio); - Penetrabilidade; Amostra reprovada.
21	911259 - FIO CIR. MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 3-0	VOLARE COMERCIO LTDA	SHALON P302MR V25	Conforme Análise SEI nº 25349147, durante a avaliação, a equipe técnica constatou que a amostra não atendeu aos seguintes requisitos: - Resistência a tração sobre nó; - Maleabilidade; - Diâmetro de arame (espessura da agulha compatível com a espessura do fio); - Penetrabilidade; Amostra reprovada.
22	911260 - FIO CIR. MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 4-0	VOLARE COMERCIO LTDA	SHALON P402MR V20	Conforme Análise SEI nº 25349172, durante a avaliação, a equipe técnica constatou que a amostra não atendeu aos seguintes requisitos: - Resistência a tração sobre nó; - Maleabilidade; - Diâmetro de arame (espessura da agulha compatível com a espessura do fio); - Penetrabilidade; Amostra reprovada.
5	917003 - FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	TECHNO FIO MODEL O: NY44CT 20 - 4.0	Amostra aprovada conforme SEI nº 25349192

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 05/05/2025, às 14:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25349216** e o código CRC **B688EDCC**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.219769-7

25349216v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 75/2025

ITEM 16

909817 - FIO CIR. DE POLIPROPILENO 5-0 AG 1,5 a 1,7CM CARDIOV. Fio cirurgico monofilamentar de polipropileno, cor azul, espessura 5-0, com 75cm de comprimento, com 2 agulhas 1/2 circulo, ponta cilíndrica, medindo 1,5 a 1,7cm, cardiov., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.

FORNECEDOR: VOLARE COMERCIO LTDA

MARCA: SHALON P502MRV15

REGISTRO: 10243410014

LOTE: 2290524060

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 CAIXA

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	(☒) Atende () Não atende
Comprimento:	(☒) Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	() Atende (☒) Não atende
Maleabilidade:	() Atende (☒) Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	(☒) Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	(☒) Atende () Não atende
Formato da ponta:	(☒) Atende () Não atende
Curvatura:	(☒) Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	() Atende (☒) Não atende
Penetrabilidade:	() Atende (☒) Não atende
Resistência do Arame:	(☒) Atende () Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	(☒) Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na Anvisa, especificações do item):	(☒) Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

() Adequada (☒) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (☒) NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 5 / 5 / 25 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

Dr. André Camargo Lima
Cirurgião de Otorrinolaringologia (RQE 14611,
CRM 7401/2011)

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 75/2025

ITEM 21

DESCRIÇÃO: 911259 - FIO CIR. MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 3-0 FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO COR AZUL, ESPESSURA 3-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO, PONTA CILINDRICA, MEDINDO DE 2,2 a 2,5CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

FORNECEDOR: VOLARE COMERCIO LTDA

MARCA: SHALON P302MRV25

REGISTRO: 10243410014

LOTE: 2340225038

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 CAIXA

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	(☒) Atende () Não atende
Comprimento:	(☒) Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	() Atende (☒) Não atende
Maleabilidade:	() Atende (☒) Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	(☒) Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	(☒) Atende () Não atende
Formato da ponta:	(☒) Atende () Não atende
Curvatura:	(☒) Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	() Atende (☒) Não atende
Penetrabilidade:	() Atende (☒) Não atende
Resistência do Arame:	(☒) Atende () Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	(☒) Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na Anvisa, especificações do item):	(☒) Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____


() Adequada (☒) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (☒) NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 5 / 5 / 25 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

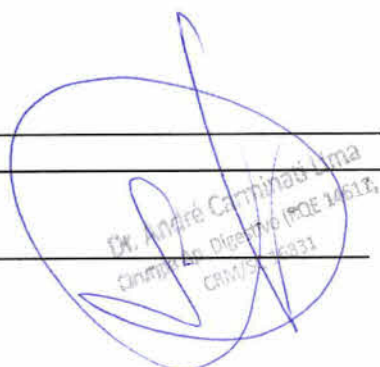

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 75/2025

ITEM 22

911260 - FIO CIR. MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 4-0 FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO COR AZUL, ESPESSURA 4-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO, PONTA CILINDRICA, MEDINDO 2,0CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

FORNECEDOR: VOLARE COMERCIO LTDA

MARCA: SHALON P402MRV20

REGISTRO: 10243410014

LOTE: 2300125069

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 CAIXA

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	☒ Atende () Não atende
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	() Atende ☒ Não atende
Maleabilidade:	() Atende ☒ Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	☒ Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	() Atende ☒ Não atende
Formato da ponta:	() Atende ☒ Não atende
Curvatura:	() Atende ☒ Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	() Atende ☒ Não atende
Penetrabilidade:	() Atende ☒ Não atende
Resistência do Arame:	☒ Atende () Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	☒ Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na Anvisa, especificações do item):	☒ Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 5 / 5 / 25 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

Dr. André Carinhato Lima
Clínica Ap. Ortopedia e Trauma 14611.
CNPJ 11.811.111

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 75/2025

ITEM: 57

917003 - FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 4.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

MARCA: TECHNOFIO NY44CT20 - 4.0 3/8 20

LOTE: 36220998

REGISTRO (ANVISA): 10378330013

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO

Diâmetro:	(☒) Atende () Não atende
Comprimento:	(☒) Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	(☒) Atende () Não atende
Maleabilidade:	(☒) Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	(☒) Atende () Não atende

2. AVALIAÇÃO DA AGULHA

Comprimento:	(☒) Atende () Não atende
Formato da ponta:	(☒) Atende () Não atende
Curvatura:	(☒) Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	(☒) Atende () Não atende
Penetrabilidade:	(☒) Atende () Não atende
Resistência do Arame:	(☒) Atende () Não atende

3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO

Apresentação Individual:	(☒) Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na Anvisa, especificações do item):	(☒) Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

(☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto (☒) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 5 / 5 / 25 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

Dr. André Caminati Lima
Cargo: Ap. Direção (RQE 14513)
Especialista em